全自動血圧計

UDEX-i

Type-I（標準）　Type-II（プリンタ付き）

設置場所を選ばない スマートなデザインと機能性

スペースをとらない コンパクトボディ

幅はわずか242mmと置き場所にも困りません。さらにボディは長く色あせない（従来比4倍の耐候性）素材を使用しました。

338
242
376
154
単位（mm）

●ソフトな肌触りで腕にフィット

旭化成テクノファイン®採用。吸汗、速乾性に優れ、べたつきません。

アームレストにはクッションが付属し、やさしく腕にフィットします。

分かりやすい測定サポートと 安心の非常停止機構

●大きなスタートボタン

大きく押しやすいスタートボタンは緑色に点灯し、測定を促します。

●安心の非常停止ボタン

ひと目で分かる位置に非常停止ボタンを配置しました。万が一の際にも押すだけで速やかに腕の締めつけを解除する安全設計です。

●音声ガイドとともにイラストが点滅し、測定手順を分かりやすくサポートします。

左右どちらの腕でも 測定可能

左右どちらの腕でも測定できます。車椅子のままでも一人で簡単に測定できるバリアフリー設計です。

*車イスのサイズや種類、乗車される方の姿勢などによって、正確に測定できないことがあります。

医療現場で最も使われる リバロッチ法

日本循環器管理研究協議会の判定基準であるリバロッチ法を基本に、オシロメトリック法を組み合わせ、様々な条件での精度を向上させました。また、内蔵の振動検出センサにより、信頼性と安全性を高めております。

高感度マイクロフォンにより脈音を診ながら一人ひとりに合わせて加圧を調整するため、スピーディに測定できます。

記録紙交換頻度が 従来の3分の1

大型ロール紙（従来比3倍）の採用により、記録紙の交換の手間が3分の1に減りました。

120/ 80(75)

36mm

エコサイズ（約1736回/1巻*）

最高血圧 120
最低血圧 80
脈拍数 75

59mm

標準サイズ（約1059回/1巻*）

最高血圧 120
最低血圧 80
脈拍数 75

104mm

ビッグサイズ（約600回/1巻*）
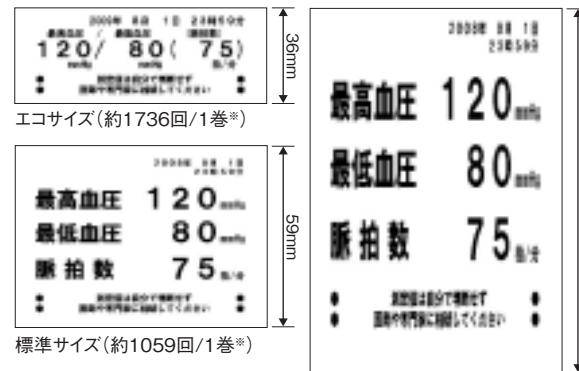
*各印字モードの使用回数の目安　専用記録紙MR-58L（63m）使用時

主な仕様

販売名称	全自動血圧計UDEX-i	
仕様	Type-Ⅰ(標準)	Type-Ⅱ(プリンタ付き)
機能	音声・通信付	プリンタ・音声・通信付
電源定格・消費電力	AC100V　50/60Hz　40VA	
電撃防護型式	クラスⅠ　B型	
測定方法	リバロッチ法+オシロメトリック法	
測定範囲	圧力 10～250mmHg、脈拍数 30～200拍/分	
計量範囲／目量	10～300mmHg / 1mmHg	
表示方法	LEDデジタル方式	
オートペーパーカッター	無し	フルカット方式／パーシャルカット方式
プリンタ	無し	感熱ラインプリンタ漢字印字
音声機能	ADPCM音声合成方式	
通信機能	RS-232C準拠	
カウンター機能	0～999999回	
外形寸法	W242mm×D376mm×H338mm	
重量	約5.0kg	約5.3kg
法定耐用年数	6年	
耐用期間	7年(25万回相当:自己認証基準による)	
保証期間	1年間	
医療機器の種別	管理医療機器(クラスⅡ)特定保守管理医療機器	
一般的名称	医用電子血圧計(JMDNコード)16173010	
認証番号	221AIBZX00065000	
型式承認番号	第Q0950号	
付属品	記録紙MR-58L 1巻(Type-Ⅱのみ)、取扱説明書	
	3P電源ケーブル(2m)、腕帯布2枚(内1枚は出荷時に取付済)	
標準価格	¥291,900(税込)	¥341,250(税込)

単位(mm)

オプション

専用架台US-1K(組立式)	¥30,450(税込)
椅子SNC-T134(エアー式)	¥13,440(税込)
腕帯布(2枚組み)	¥6,300(税込)
記録紙MR-58L(1箱6巻入)	¥7,560(税込)
盗難防止用ロック(鎖は別売)	¥2,625(税込)
キャリングケース	¥63,000(税込)

盗難防止用ロック
No.1000-40L/S-L
※鎖は別売

キャリングケース
外形寸法:
W535mm × D340mm × H475mm
重量:約8.0kg
※丈夫なアルミエンボス仕様

Type-Ⅱ(プリンタ付)・専用架台・
椅子
※椅子にはキャスターと固定脚が同梱されています

Type-Ⅰ(標準)

血圧測定時の注意

- 測定前は5分くらい安静にし、呼吸を整えてから測定して下さい。
- 測定中は体を動かしたり、しゃべったりしないで下さい。
- 上着やセーターは脱いで、裸腕か薄手のシャツで測定して下さい。
- 薄手の衣類の場合は、袖をまくらず測定して下さい。
- 腕帯と心臓の高さが違うと正しく測定できません。椅子の高さを調整して腕帯と心臓の高さを同じにして下さい。
- 腕が充分に奥まで入っていないと正しく測定できません。腕は肩口まで充分奥に入れて下さい。
- 腕の直径が5cm以下の方、及び小学生以下の子供は測定できません。
- 測定中、いたいと感じたり、気分が悪くなった時は、慌てずに「非常停止ボタン」を押して下さい。腕帯内の空気が速やかに抜け、腕を抜くことができます。

○写真はカタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

Canon
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社

営業推進統括本部
http://www.canon-lcs.co.jp
〒566-0012 摂津市庄屋1丁目14番12号　☎(06) 6382-7009
〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17番4号　☎(03) 3814-8229

■商品に関するお問い合わせは下記まで
札　幌(011)736-0010・仙　台(022)236-3621・新　潟(025)243-6391・さいたま(048)663-2221
東日本第一(03)3814-7851・東日本第二(03)3814-7850・神奈川(045)476-2860・中　部(052)531-6231
金　沢(076)237-7511・京　都(075)691-5101・近畿第一(06)6382-3787・近畿第二(06)6382-8701
神　戸(078)651-2601・岡　山(086)232-6721・広　島(082)232-1341・九　州(092)472-0241
鹿児島(099)266-3141

本社／〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階　☎(06) 6942-4901(代)

製造販売元:株式会社エルクエスト
千葉県富里市大和741

マネジメントシステム認証取得
Certified Management System
- ISO 9001,JIS Q 9001
- ISO 14001, JIS Q 14001
- ISO 13485

PRINTED WITH SOY INK
このカタログには環境にやさしい大豆油インキ・再生紙を使用しています。

20130105SZ